


## フルタイムエアゾールの吸入方法

1

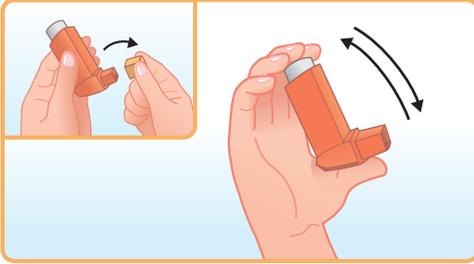

アダプターについているキャップの両端をつまみでずします。ボンベの中の薬が均一にまじりあうようによく振ってください。

4




口から吸入口を離し、少なくとも3~4秒以上息を止め、その後ゆっくりと静かに息をはき、元の呼吸に戻してください。

2




無理をしない程度に息をはき出した後、舌を下げ、のどを広げた状態にしてください。

5

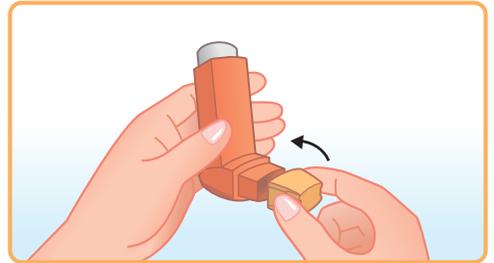

使用後は、アダプターにキャップをつけてください。医師の指示によりフルタイムエアゾールをもう1回吸入する場合は、1~4の操作を繰り返してください。

3

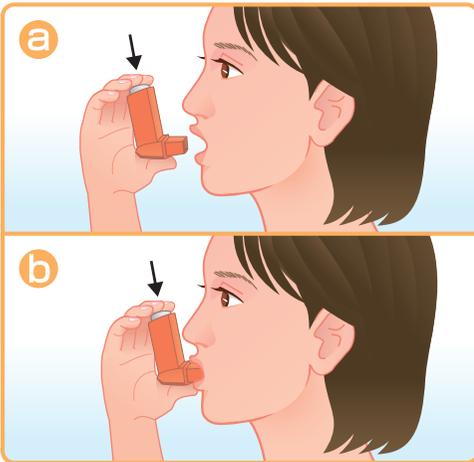

図aまたは図bのように息をゆっくり吸い込みながらボンベの底を強く1回押して吸入してください。

図a 吸入口をくわえないで口より約4cm離して吸入します。

図b 吸入口を唇で軽くくわえて吸入します。または、歯で軽くくわえて吸入します。

aまたはbのいずれの方法で吸入するかは先生の指示に従ってください。また、うまく吸入できない場合は先生に相談してください。

6



吸入後は、のどや口の中に残っている薬を洗い流すために必ずうがいをしてください。

■ 吸入用補助器具（スパーサー）を使用する場合は、吸入用補助器具に添付されている使用説明書をご参照ください。

# フルタイムエアゾールをご使用になる方へ

## <横から見た図>



- 薬剤の吸入は裏面の使用説明書をよく読んでから行ってください。
- フルタイム100 $\mu$ gエアゾールは60回、フルタイム50 $\mu$ gエアゾールは120回の定量噴霧が可能です。

## 用法・用量

主治医から指示された用法・用量に従ってください。

1回 吸入 / 1日 回  
[ 朝 ( 吸入 ) ・ 就寝前 ( 吸入 ) ]

## エアゾールの保管

- 1) アダプターは時々流水か温湯で十分に洗浄し、清潔に保管してください。
- 2) 30 $^{\circ}$ C以上の場所に保管しないでください。
- 3) ボンベは火中に投入しないでください。
- 4) 使用後は、地方自治体により定められたボンベの廃棄処理法に従ってください。
- 5) ボンベに穴を開けるときは空にしてから開けてください。

## アダプターの洗浄・乾燥

**1** アダプターは噴霧を良好に保つため、少なくとも週1回以上流水か温湯でよく洗い、十分に乾燥させてください (洗浄・乾燥が不十分だと噴霧不良の原因になります)。


**2** 洗浄直後に使用する必要が生じた場合、アダプターを振るなどして水分をよく切ってからボンベを装着し、空気中に数回空噴霧して噴霧を確認した後、使用してください。使用后、再度洗浄、乾燥してください。



アダプターからキャップとボンベを取りはずします。



アダプターを流水または温湯でよく洗ってください。ボンベは絶対に濡らさないでください。

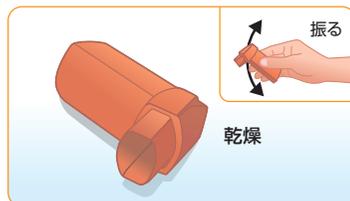

振るなどして水分をよく切ってアダプターの内側と外側をよく拭き、十分に乾燥させてください。

パソコン、携帯電話から動画による吸入法などもご覧いただけます。

▶ <https://kusurigsk.jp/>

2次元コードが読み取れない場合は、インターネットに上記アドレスを直接ご入力ください。



フルタイム エアゾールの使い方のお問い合わせは

**TEL: 0120-562-306**

(9:00～17:45 / 土日祝日および当社休業日を除く)